


专家信息表

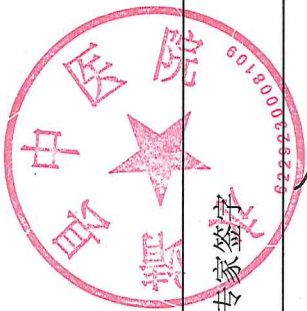

| 姓名 | 专业 | 专家签字 |
|-----|------|------|
| 王可群 | 医学 | 王可群 |
| 王云 | 法律 | 王云 |
| 王恩博 | 医学影像 | 王恩博 |
| 杨发 | 医学检验 | 杨发 |
| 王博 | 临床 | 王博 |

政府采购进口产品申请表

2024年 11月 13日

| | |
|----------|--|
| 申请单位 | 永靖县中医院 |
| 采购项目名称 | 永靖县中医院射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、氩气刀、支气管镜等设备采购项目 |
| 采购项目金额 | 172.8 万元 |
| 采购产品金额 | 35 万元 |
| 进口产品设备名称 | 医用臭氧治疗仪 |
| 采购人申请原因 | <p>为满足医院业务发展的需求，所需产品经调研、比较，国内同类仪器在技术指标上与进口仪器设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距。进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好。综合考虑所需仪器的参数、性能、价格等，国内设备暂无法满足采购人的技术要求，故我院申请购买进口设备。</p> <p>盖章 2024 年 11月 13日</p> |
| 主管部门审核意见 | <p>盖章 2024 年 11月 13日</p> |
| 监管部门审核意见 | <p>盖章 2024 年 11月 13日</p> |

表 1 政府采购进口产品申请表

| | |
|------------------|--|
| 申请单位 | 永靖县中医院 |
| 申请文件名称 | 关于《同意永靖县中医院采购射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、氩气刀、支气管镜等医疗设备的》批复 |
| 申请文号 | 永卫发〔2024〕402 号 |
| 采购项目名称 | 医用臭氧治疗仪 |
| 采购产品金额 | 35 万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 永靖县中医院射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、氩气刀、支气管镜等设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 172.8 万元 |
| 项目使用单位 | 永靖县中医院 |
| 项目组织单位 | 永靖县中医院 |
| 申 请 理 由 | <p>为满足医院业务发展的需求，所需产品经调研、比较，国内同类仪器在技术指标上与进口仪器设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距。进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好。综合考虑所需仪器的参数、性能、价格等，国内设备暂无法满足采购人的技术要求，故我院申请购买进口设备。</p> <div><div>永靖县中医院</div><div>盖章</div><div>2024 年 11 月 13 日</div><div>6229230006109</div></div> |

表2

政府采购进口产品所属行业主管部门意见


| | |
|---|---------------------------------------|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 永靖县中医院 |
| 拟采购产品名称 | 医用臭氧治疗仪 |
| 拟采购产品金额 | 35 万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 永靖县中医院射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、氩气刀、支气管镜等设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 172.8 万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| 原因阐述：为满足医院业务发展的需求，所需产品经调研、比较，国内同类仪器在技术指标上与进口仪器设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距。进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好。综合考虑所需仪器的参数、性能、价格等，国内设备暂无法满足采购人的技术要求，故我院申请购买进口设备。 | |
| 三、进口产品所属行业主管部门意见 | |
| <div style="text-align: right;"> 盖章 2024年11月13日</div> | |

表3 政府采购进口产品专家论证意见

| | |
|---|---------------------------------------|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 永靖县中医院 |
| 拟采购产品名称 | 医用臭氧治疗仪 |
| 拟采购产品金额 | 35 万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 永靖县中医院射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、氩气刀、支气管镜等设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 172.8 万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| <p>原因阐述：</p> <p>为满足医院业务发展的需求，所需产品经调研、比较，国内同类仪器在技术指标上与进口仪器设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距。进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好。综合考虑所需仪器的参数、性能、价格等，国内设备暂无法满足采购人的技术要求，故我院申请购买进口设备。</p> | |
| 三、专家论证意见 | |
| <p>永靖县中医院拟采购的医用臭氧治疗仪，为微创治疗设备，要求参数高，创伤小等特点。进口同类设备优势比较明显。故建议采购进口产品。</p> <p style="text-align: right;">白可群 专家签字</p> <p style="text-align: right;">2024 年 11 月 13 日</p> | |

表3 政府采购进口产品专家论证意见

| | |
|---|---------------------------------------|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 永靖县中医院 |
| 拟采购产品名称 | 医用臭氧治疗仪 |
| 拟采购产品金额 | 35 万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 永靖县中医院射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、氩气刀、支气管镜等设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 172.8 万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| 原因阐述： 为满足医院业务发展的需求，所需产品经调研、比较，国内同类仪器在技术指标上与进口仪器设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距。进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好。综合考虑所需仪器的参数、性能、价格等，国内设备暂无法满足采购人的技术要求，故我院申请购买进口设备。 | |
| 三、专家论证意见 | |
| 此次采购的医用臭氧治疗仪不属于我国禁止或限制进口的产品，因此本次采购符合我国关于进出口产品相应的法律法规，程序合法。 | |
| 专家签字 王松 | |
| 2024 年 11 月 13 日 | |


表3 政府采购进口产品专家论证意见

| | |
|--|---------------------------------------|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 永靖县中医院 |
| 拟采购产品名称 | 医用臭氧治疗仪 |
| 拟采购产品金额 | 35 万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 永靖县中医院射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、氩气刀、支气管镜等设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 172.8 万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| 原因阐述： 为满足医院业务发展的需求，所需产品经调研、比较，国内同类仪器在技术指标上与进口仪器设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距。进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好。综合考虑所需仪器的参数、性能、价格等，国内设备暂无法满足采购人的技术要求，故我院申请购买进口设备。 | |
| 三、专家论证意见 | |
| <p>采购方所需“医用臭氧治疗仪”需产品具备触摸屏版、脚踏式浓度设置功能及连续不间断取气功能，国内同类设备其操作灵敏性、安全性及稳定性均较进口设备差，进口设备故障率较低，性能更稳定，故建议采购进口设备。</p> <p style="text-align: right;">马恩泽 专家签字</p> <p style="text-align: right;">2024年 11月 13日</p> | |

表3 政府采购进口产品专家论证意见

| | |
|--|---------------------------------------|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 永靖县中医院 |
| 拟采购产品名称 | 医用臭氧治疗仪 |
| 拟采购产品金额 | 35 万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 永靖县中医院射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、氩气刀、支气管镜等设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 172.8 万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| 原因阐述： 为满足医院业务发展的需求，所需产品经调研、比较，国内同类仪器在技术指标上与进口仪器设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距。进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好。综合考虑所需仪器的参数、性能、价格等，国内设备暂无法满足采购人的技术要求，故我院申请购买进口设备。 | |
| 三、专家论证意见 | |
| <p>采购方拟采购的医用臭氧治疗仪技术参数要求，具有触摸板触摸滑轨式浓度设置，一步到位，操作简单方便，避免触点式反复触碰；有连续不间断取气功能，负压抽真空功能，专用臭氧套袋为一次性无菌包装并有单独注册证；臭氧发生器带有1.4L小泵气泵，使用方便，可以连接中心供气使用。国产同类产品技术参数达不到上述要求，故建议采购医用臭氧治疗仪。</p> <p style="text-align: right;">专家签字 杨光 2024年 11月 13 日</p> | |

表3 政府采购进口产品专家论证意见

| | |
|--|---------------------------------------|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 永靖县中医院 |
| 拟采购产品名称 | 医用臭氧治疗仪 |
| 拟采购产品金额 | 35 万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 永靖县中医院射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、氩气刀、支气管镜等设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 172.8 万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| 原因阐述： 为满足医院业务发展的需求，所需产品经调研、比较，国内同类仪器在技术指标上与进口仪器设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距。进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好。综合考虑所需仪器的参数、性能、价格等，国内设备暂无法满足采购人的技术要求，故我院申请购买进口设备。 | |
| 三、专家论证意见 | |
| <p>进口医用臭氧治疗仪具有连续不间断取气功能，负压抽真空功能，有专用臭氧套装设备，进口设备技术成熟，产品性能稳定，耐用性及可操作性好，故建议采购方采购进口产品</p> <p style="text-align: right;">专家签字 </p> <p style="text-align: right;">2024 年 11 月 13 日</p> | |

政府采购进口产品申请表

2024年 11月 13日

| | |
|----------|---|
| 申请单位 | 永靖县中医院 |
| 采购项目名称 | 永靖县中医院射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、氩气刀、支气管镜等设备采购项目 |
| 采购项目金额 | 172.8 万元 |
| 采购产品金额 | 50 万元 |
| 进口产品设备名称 | 支气管镜 |
| 采购人申请原因 | <p>为满足医院业务发展的需求，所需产品经调研、比较，国内同类仪器在技术指标上与进口仪器设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距。进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好。综合考虑所需仪器的参数、性能、价格等，国内设备暂无法满足采购人的技术要求，故我院申请购买进口设备。</p> <p style="text-align: right;">  盖章 2024 年 11 月 13 日 </p> |
| 主管部门审核意见 | <p style="text-align: right;">  盖章 2024 年 11 月 13 日 </p> |
| 监管部门审核意见 | <p style="text-align: right;">  盖章 2024 年 11 月 13 日 </p> |

表 1 政府采购进口产品申请表


| | |
|------------------|--|
| 申请单位 | 永靖县中医院 |
| 申请文件名称 | 关于《同意永靖县中医院采购射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、氩气刀、支气管镜等医疗设备的》批复 |
| 申请文号 | 永卫发〔2024〕402 号 |
| 采购项目名称 | 支气管镜 |
| 采购产品金额 | 50 万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 永靖县中医院射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、氩气刀、支气管镜等设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 172.8 万元 |
| 项目使用单位 | 永靖县中医院 |
| 项目组织单位 | 永靖县中医院 |
| 申 请 理 由 | <p>为满足医院业务发展的需求，所需产品经调研、比较，国内同类仪器在技术指标上与进口仪器设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距。进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好。综合考虑所需仪器的参数、性能、价格等，国内设备暂无法满足采购人的技术要求，故我院申请购买进口设备。</p> <div><p>2024年11月13日</p></div> |

表2

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

| | |
|---|---------------------------------------|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 永靖县中医院 |
| 拟采购产品名称 | 支气管镜 |
| 拟采购产品金额 | 50 万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 永靖县中医院射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、氩气刀、支气管镜等设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 172.8 万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| 原因阐述：为满足医院业务发展的需求，所需产品经调研、比较，国内同类仪器在技术指标上与进口仪器设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距。进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好。综合考虑所需仪器的参数、性能、价格等，国内设备暂无法满足采购人的技术要求，故我院申请购买进口设备。 | |
| 三、进口产品所属行业主管部门意见 | |
| <div>永靖县卫生健康局</div> <div>盖章</div> <div>2024年11月13日</div> | |

表3 政府采购进口产品专家论证意见

| | |
|--|---------------------------------------|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 永靖县中医院 |
| 拟采购产品名称 | 支气管镜 |
| 拟采购产品金额 | 50 万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 永靖县中医院射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、氩气刀、支气管镜等设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 172.8 万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| <p>原因阐述：</p> <p>为满足医院业务发展的需求，所需产品经调研、比较，国内同类仪器在技术指标上与进口仪器设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距。进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好。综合考虑所需仪器的参数、性能、价格等，国内设备暂无法满足采购人的技术要求，故我院申请购买进口设备。</p> | |
| 三、专家论证意见 | |
| <p>永靖县中医院拟采购的支气管镜要求技术参数高，与医院设备兼容。进口设备在精度、稳定、灵敏性、技术成熟性、安全性方面比较有优势，故建议采购进口产品。</p> <p style="text-align: right;">专家签字 白月君 2024 年 11 月 13 日</p> | |

表3 政府采购进口产品专家论证意见

| | |
|--|---------------------------------------|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 永靖县中医院 |
| 拟采购产品名称 | 支气管镜 |
| 拟采购产品金额 | 50 万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 永靖县中医院射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、氩气刀、支气管镜等设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 172.8 万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| <p>原因阐述：</p> <p>为满足医院业务发展的需求，所需产品经调研、比较，国内同类仪器在技术指标上与进口仪器设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距。进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好。综合考虑所需仪器的参数、性能、价格等，国内设备暂无法满足采购人的技术要求，故我院申请购买进口设备。</p> | |
| 三、专家论证意见 | |
| <p>本次采购的支气管镜不属于国家限制或禁止进口的产品，因此本次采购符合《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》等法律法规，采购合法有效。</p> <p style="text-align: right;">专家签字 王</p> <p style="text-align: right;">2024 年 11 月 13 日</p> | |


表3 政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 | |
|--|---------------------------------------|
| 申请单位 | 永靖县中医院 |
| 拟采购产品名称 | 支气管镜 |
| 拟采购产品金额 | 50 万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 永靖县中医院射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、氩气刀、支气管镜等设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 172.8 万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| 原因阐述： 为满足医院业务发展的需求，所需产品经调研、比较，国内同类仪器在技术指标上与进口仪器设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距。进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好。综合考虑所需仪器的参数、性能、价格等，国内设备暂无法满足采购人的技术要求，故我院申请购买进口设备。 | |
| 三、专家论证意见 | |
| <p>采购方拟采购的支气管镜技术参数要求，具有顺次成像方式的CCD；弯曲角度上$\geq 120^\circ$，下$\geq 130^\circ$；插入管左右旋转120°。国产同类设备技术参数达不到上述要求，所以建议采购进口支气管镜。</p> <p style="text-align: right;">杨光 专家签字</p> <p style="text-align: right;">2024 年 11 月 13 日</p> | |

表3 政府采购进口产品专家论证意见

| | |
|---|---------------------------------------|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 永靖县中医院 |
| 拟采购产品名称 | 支气管镜 |
| 拟采购产品金额 | 50 万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 永靖县中医院射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、氩气刀、支气管镜等设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 172.8 万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| 原因阐述： 为满足医院业务发展的需求，所需产品经调研、比较，国内同类仪器在技术指标上与进口仪器设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距。进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好。综合考虑所需仪器的参数、性能、价格等，国内设备暂无法满足采购人的技术要求，故我院申请购买进口设备。 | |
| 三、专家论证意见 | |
| 采购方所需“支气管镜”属侵入性检查设备，对设备性能参数要求较高，国内同类设备在支气管镜清晰度和灵敏度及精度等方面均较进口设备差，且进口设备更具安全性和稳定性，故障率低，故建议采购进口设备。 | |
| 马恩萍 专家签字 2024 年 1 月 13 日 | |

表3 政府采购进口产品专家论证意见

| | |
|--|---------------------------------------|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 永靖县中医院 |
| 拟采购产品名称 | 支气管镜 |
| 拟采购产品金额 | 50 万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 永靖县中医院射频控温热凝器、医用臭氧治疗仪、氩气刀、支气管镜等设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 172.8 万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| <p>原因阐述：</p> <p>为满足医院业务发展的需求，所需产品经调研、比较，国内同类仪器在技术指标上与进口仪器设备相比，精度、稳定性、灵敏性、安全性等方面有一定差距。进口设备技术成熟，产品性能优越，耐用性及可操作性好。综合考虑所需仪器的参数、性能、价格等，国内设备暂无法满足采购人的技术要求，故我院申请购买进口设备。</p> | |
| 三、专家论证意见 | |
| <p>进口超高清电子支气管镜具有插入管左右旋转120°、自由度上7210°下7130°，进口仪器设备相比国内同类产品，精准度高，稳定性好，灵敏性、安全性好，故建议采购方采购进口产品</p> <p style="text-align: right;">专家签字 </p> <p style="text-align: right;">2024 年 11 月 13 日</p> | |